

铜精矿化学成分分析

循环比对结果报告

矿冶 | 有品质才有市场
科学技术指引未来
有改善才有进步

CAMTA
中国矿冶检测机构联盟



中国矿冶检测机构联盟

China Mining and Metallurgical Inspection Institute Alliance

2017

中国矿冶检测机构联盟



2017 年铜精矿化学成分分析循环比对结果报告

组织实施机构： 中国矿冶检测机构联盟秘书处
国家重有色金属质量监督检验中心
北矿检测技术有限公司

负 责 人：李华昌

联 络 人：于力 姜求韬 刘玮

电话/传真：010-59069658、010-59069683 （FAX）

Web site: <http://www.analysis-bgrimm.com/>

联系地址：北京市大兴区北兴路(东段) 22 号 A702 室



目录

一. 前 言	3
二. 统计处理结果及能力评价	5
1 原始数据	5
2 Cu 的数据分析	12
3 Au 的数据分析	18
4 Ag 的数据分析	24
附录 A 参与单位：（排名按首字拼音顺序）	31
附录 B 山东祥光集团分析测试中心铜精矿样品均匀性检验报告	33
附录 C 北矿检测技术有限公司 2017 年铜精矿样品均匀性检验报告	36
附录 D 统计分析有关统计量的意义及其计算方法	39
附录 E 循环比对计划作业指导书	41

一. 前 言

1. 概述

本报告总结了铜精矿中 Cu、Au、Ag 含量的测定循环比对结果。

本报告记载了各参与单位的原始数据及数据比对结果。

报告中各参与单位以实验室编号形式 (LAB××) 出现。除秘书处外, 各参与单位仅知晓本单位编号。由于各单位提供的平行测定值数量差异, 可能影响最终数据比对结果。

2. 范围

本次循环测试要求对铜、金、银 3 个元素进行分析, 报告以各参与单位的原始数据为基础, 通过各种分析工具得出比对结果。

3. 报告简介

感谢各单位积极参与本次比对测试, 希望本比对报告对各单位的分析流程管理、内部质量控制有一定的帮助。

报告中, 各单位分析的精准度及允许误差通过如下分析项进行分析论证: Z 比分数 (标准化值)、总体平均值, 中位值, 标准化 IQR、最大值、最小值、极差、稳健 CV (%)、主效应图、95%置信区间概率图、各元素 Z 比分数柱状图等。

4. 参与条款

各参与单位报告平行测定值及相应的分析方法, 作为比对依据;

5. 本次分析不具任何商业价值和评判价值。

6. 样品准备

本次比对测试样品为山东祥光集团提供的铜精矿，经 105 摄氏度高温持续烘干，磨样，混合，过筛后，经均匀性检验，用铝箔真空包装，每份样品 120g，通过 EMS 快递发送至各实验室。

7. 比对原理

平行测定值是各分析工具的数据基础，分析前输入平行测定值，各分析工具以输入的平行测定值为依据计算出平均值，计算各参与单位的 Z 比分数(标准化值)，方差齐性测试、主效应图等分析用 Minitab 17.2 工具软件进行统计分析。

8. 统计分析的设计及能力评价原则

对本次循环比对计划实验室的检测结果，按下式计算 Z 比分数

$$Z = (x - X) / \sigma$$

式中：x-实验室测试结果；

X-指定值；

σ -变动性度量值（目标标准偏差）。

本次循环比对计划统计分析采用稳健（Robust）技术处理，以稳健平均值作为指定值，稳健标准偏差为变动性度量值（目标标准偏差），计算各实验室结果的 Z 比分数（Z 比分数）。稳健平均值和稳健标准偏差的计算及意义参见 ISO 13528：2005《利用实验室间比对的能力验证中的统计方法》。

本次循环比对计划涉及的其它统计量，如：结果数、最小值、最大值和极差等，其意义及相关计算方法参见 CNAS GL02:2006《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》。

本次循环比对统计分析有关统计量的意义及其计算方法详见 GB/T 28043-2011/ISO13528:2005。

本次循环比对计划以 Z 比分数评价实验室的结果，即：

$|Z| \leq 2$ 为满意结果；

$2 < |Z| < 3$ 为有问题结果（可疑值）；

$|Z| \geq 3$ 为不满意结果（离群值）。

为了清晰表示各实验室参加能力验证计划的结果，将 Z 比分数按大小顺序排列作柱状图，每一个柱条标有该实验室的代码。从该柱状图上，每一个实验室很容易将其结果与其他参加实验室进行比较，了解其结果在本次计划中所处的水平。

二. 统计处理结果及能力评价

1. 原始数据



实验室编号	Cu 分析结果						
	平行分析结果, %						平均值, %
	1	2	3	4	5	6	
LAB01	35.79	35.83	35.77	35.86			35.81
LAB02	35.45	35.32	35.33				35.37
LAB03	35.62	35.62					35.62
LAB04	35.78	35.66	35.77	35.81			35.76
LAB06	35.74	35.75	35.94	35.92			35.84
LAB07	34.85	34.75					34.80
LAB08	35.71	35.75					35.73
LAB09	35.60	35.56	35.62	35.65	35.64	35.58	35.61
LAB11	35.68	35.72					35.70
LAB12	35.27	35.00	35.08	35.45			35.20
LAB13	35.88	35.85	35.80	35.88			35.85
LAB14	35.63	35.77					35.70
LAB15	35.75	35.77	35.80	35.74			35.77
LAB16	35.69	35.69					35.69
LAB17	35.92	35.92	35.92	35.83	35.92	35.86	35.90
LAB18	35.70	35.67	35.73				35.70
LAB19	35.85	35.81	35.67	35.63			35.72
LAB21	35.68	35.66					35.67
LAB22	35.37	35.32	35.48	35.47			35.41
LAB23	35.67	35.39	35.57	35.67			35.58
LAB24	35.84	35.88	35.73				35.81
LAB25	35.85	35.83	35.64	35.75	35.79	35.77	35.77
LAB26	35.60	35.76	35.57	35.85			35.70
LAB27	35.78	35.71	35.73				35.74
LAB28	35.80	35.83	35.86	35.77			35.82
LAB30	35.84	35.88	36.00	35.84			35.89
LAB31	35.69	35.81	35.91	35.86	35.58	35.63	35.75
LAB32	35.70	35.69					35.70
LAB33	35.43	35.19	35.43	35.69			35.44



LAB34	35.85	35.79					35.82
LAB35	35.58	35.68					35.63
LAB36	35.62	35.62	35.69	35.65	35.65		35.65
LAB38	35.90	35.88					35.89
LAB39	35.79	35.76	35.31	35.30			35.54
LAB41	35.85	35.88	35.88				35.87
LAB43	35.81	35.83					35.82
LAB44	35.71	35.86	35.71	35.72			35.75
LAB45	35.65	35.81					35.73
LAB46	36.00	35.83					35.92
LAB47	35.81	35.86	35.84				35.84
LAB48	35.88	35.82	35.89	35.85			35.87
LAB49	35.67	35.66					35.66
LAB50	35.98	35.99	36.00	36.03			36.00
LAB51	35.85	35.82	35.84	35.86			35.84
LAB52	35.90	35.99	35.94				35.94
LAB53	35.56	35.69	35.68	35.62	35.57	35.67	35.63
LAB54	35.63	35.56					35.59
LAB55	35.60	35.68					35.64
LAB56	35.68	35.72	35.64	35.73	35.69		35.69
LAB57	35.82	35.76					35.79
LAB58	35.82	35.66					35.74
LAB59	35.94	35.98					35.96
LAB60	35.60	35.60	35.30				35.50
LAB61	35.84	35.84	35.87	35.82			35.84
LAB64	35.76	35.88					35.82
LAB67	35.80	36.02	35.80	35.95			35.89
LAB68	35.93	35.84	35.79	35.90			35.87
LAB70	35.61	35.72	35.75	35.92			35.74
LAB71	35.60	35.63	35.63	35.64	35.65	35.65	35.63
LAB72	35.80	35.78	35.78	35.78	35.77	35.77	35.78
LAB73	35.82	35.83	35.80	35.82	35.83	35.80	35.82



实验室编号	Au 分析结果						
	平行分析结果, g/t						平均值, g/t
	1	2	3	4	5	6	
LAB01	3.20	3.65	3.44				3.43
LAB02	2.62	2.55	2.64	2.50			2.58
LAB03	3.09	3.00					3.04
LAB06	3.19	3.13					3.16
LAB07	2.52	2.59					2.56
LAB08	3.20	3.00					3.10
LAB09	3.44	3.44	3.44				3.44
LAB11	3.40	3.40	3.50				3.43
LAB12	2.77	2.86	2.92	3.12			2.92
LAB13	3.12	2.98	3.21	3.15			3.12
LAB15	3.40	3.00	2.87				3.09
LAB16	3.20	3.13					3.17
LAB17	3.80	3.66	3.70	3.70			3.71
LAB18	3.10	3.00	3.20				3.10
LAB19	4.00	4.10					4.05
LAB21	3.10	3.00					3.05
LAB22	3.50	3.60	3.30	3.40			3.45
LAB23	2.87	2.87	2.67	3.08			2.87
LAB24	3.13	3.20	3.07				3.13
LAB25	2.93	3.13	3.00	3.07			3.03
LAB26	3.08	3.19	3.28	3.27			3.20
LAB27	3.07	3.00	3.07				3.05
LAB28	3.12	3.24					3.18
LAB31	3.11	3.01					3.06
LAB33	2.50	2.80	3.20	3.10			2.90
LAB34	3.30	3.20					3.25
LAB35	3.00	3.14					3.07
LAB36	3.40	3.27	3.44				3.37
LAB38	2.87	2.87					2.87



LAB39	3.30	3.10	3.20	3.20			3.20
LAB41	3.15	3.42	3.39				3.32
LAB43	3.30	3.30					3.30
LAB44	3.00	3.33	3.00				3.11
LAB45	3.08	3.12					3.10
LAB46	2.87	3.00					2.94
LAB47	3.40	3.53	3.38				3.44
LAB48	3.40	3.67	3.69	3.59			3.59
LAB49	2.94	2.96					2.95
LAB50	4.00	3.10	3.30	3.15	3.14		3.34
LAB51	3.07	3.20	2.87	2.93			3.02
LAB52	2.91	3.01					2.96
LAB54	3.30	3.45	3.50	3.35			3.40
LAB55	3.80	3.46	3.25	3.96	3.55		3.60
LAB56	3.40	3.20					3.30
LAB57	3.23	3.17					3.20
LAB58	3.04	3.00					3.02
LAB59	3.31	3.30					3.30
LAB60	3.30	2.60	2.90				2.93
LAB61	3.15	2.95	2.95	3.25			3.08
LAB64	2.99	3.16					3.08
LAB66	0.65	0.80	3.25	3.50			2.03
LAB67	3.00	3.20	3.11				3.10
LAB68	3.40	3.30	3.30	3.50			3.38
LAB70	2.90	2.93					2.92
LAB71	3.03	3.09	3.09	3.16	3.16	3.16	3.12
LAB72	3.29	3.23	3.16	3.09	3.23	3.03	3.17
LAB73	3.23	3.21	3.16	3.12			3.18



实验室编号	Ag 分析结果						
	平行分析结果, g/t						平均值, g/t
	1	2	3	4	5	6	
LAB01	161.8	165.9	161.1				162.9
LAB02	160.1	160.0	152.0				157.4
LAB03	159.5	160.0					159.8
LAB06	172.2	171.6					171.9
LAB07	169.9	167.7					168.8
LAB08	159.3	157.3					158.3
LAB09	150.7	156.0	154.3				153.7
LAB11	164.0	165.0	165.8				164.9
LAB12	165.1	165.5	169.5	160.1	158.4		163.7
LAB13	159.8	162.0	164.2	159.0			161.2
LAB14	163.5	166.4					165.0
LAB15	159.2	159.2	153.2	161.8			158.4
LAB16	162.2	163.5					162.9
LAB17	160.4	161.9	161.0	160.6			160.9
LAB18	165.0	163.0	160.0	162.0			162.5
LAB19	162.0	164.0					163.0
LAB21	162.2	165.1	160.1	157.6			161.3
LAB22	149.0	149.0	162.0	156.0			154.0
LAB23	151.5	156.1	152.5	146.0	147.3		150.7
LAB24	166.6	163.6	162.2				164.1
LAB25	160.3	160.8	158.9	158.1			159.5
LAB26	160.0	158.4	161.1	158.6			159.5
LAB27	162.9	162.3	161.3	159.3			161.5
LAB28	165.6	165.0					165.3
LAB30	160.1	163.0					161.6
LAB31	169.1	166.1					167.6
LAB33	160.3	180.7	170.5	160.3			168.0
LAB34	158.8	155.9					157.4
LAB35	162.8	163.2					163.0



LAB36	166.6	169.0	160.1				165.2
LAB38	159.1	162.5					160.8
LAB39	160.1	156.8	162.8	151.6			157.8
LAB41	158.7	158.2	158.8				158.6
LAB43	158.5	160.4					159.5
LAB44	174.4	168.2	167.5				170.0
LAB45	164.1	166.3					165.2
LAB46	162.8	160.2					161.5
LAB47	161.4	160.0	165.9				162.4
LAB48	161.6	160.7	158.4	160.3			160.2
LAB49	146.8	148.7					147.8
LAB50	157.1	159.2	160.4	156.1	159.1		158.4
LAB51	159.7	155.7	150.0	149.5			153.7
LAB52	162.6	166.2	166.5				165.1
LAB53	158.2	163.7	170.5	155.9	168.6	166.2	163.9
LAB54	151.1	153.1					152.1
LAB55	167.6	177.5	165.9	164.9	170.1	178.8	170.8
LAB56	162.4	168.5	162.2				164.4
LAB57	162.7	161.9					162.3
LAB58	160.0	157.2					158.6
LAB59	164.1	163.5					163.8
LAB60	153.2	150.8	150.1				151.4
LAB61	157.4	159.8	159.9	156.1			158.3
LAB64	159.2	160.4					159.8
LAB66	274.2	281.0	143.7	276.0			243.7
LAB67	159.0	158.1	132.4				149.8
LAB68	161.8	162.8	158.9	158.8			160.6
LAB70	164.8	165.8					165.3
LAB71	160.6	160.7	160.8	160.8	162.5	163.3	161.4
LAB72	162.0	162.0	161.0	161.0	160.0	159.0	160.8
LAB73	164.0	165.4	163.9				164.4



2. Cu 的数据分析

实验室编号	平均值	Z 比分数	与中位值的差, %
LAB01	35.81	0.49	0.06
LAB02	35.37 §	-3.11	-0.38
LAB03	35.62	-1.06	-0.13
LAB04	35.76	0.08	0.01
LAB06	35.84	0.74	0.09
LAB07	34.80 §	-7.77	-0.95
LAB08	35.73	-0.16	-0.02
LAB09	35.61	-1.14	-0.14
LAB11	35.70	-0.41	-0.05
LAB12	35.20 §	-4.50	-0.55
LAB13	35.85	0.82	0.10
LAB14	35.70	-0.41	-0.05
LAB15	35.77	0.16	0.02
LAB16	35.69	-0.49	-0.06
LAB17	35.90	1.20	0.15
LAB18	35.70	-0.41	-0.05
LAB19	35.72	-0.25	-0.03
LAB21	35.67	-0.65	-0.08
LAB22	35.41*	-2.78	-0.34
LAB23	35.58	-1.39	-0.17
LAB24	35.81	0.49	0.06
LAB25	35.77	0.16	0.02
LAB26	35.70	-0.41	-0.05
LAB27	35.74	-0.08	-0.01
LAB28	35.82	0.57	0.07
LAB30	35.89	1.14	0.14
LAB31	35.75	0.00	0.00
LAB32	35.70	-0.41	-0.05





LAB33	35.44*	-2.58	-0.31
LAB34	35.82	0.57	0.07
LAB35	35.63	-0.98	-0.12
LAB36	35.65	-0.82	-0.10
LAB38	35.89	1.14	0.14
LAB39	35.54	-1.72	-0.21
LAB41	35.87	0.98	0.12
LAB43	35.82	0.57	0.07
LAB44	35.75	0.00	0.00
LAB45	35.73	-0.16	-0.02
LAB46	35.92	1.39	0.17
LAB47	35.84	0.74	0.09
LAB48	35.87	0.98	0.12
LAB49	35.66	-0.74	-0.09
LAB50	36.00*	2.04	0.25
LAB51	35.84	0.76	0.09
LAB52	35.94	1.55	0.19
LAB53	35.63	-0.98	-0.12
LAB54	35.59	-1.31	-0.16
LAB55	35.64	-0.90	-0.11
LAB56	35.69	-0.49	-0.06
LAB57	35.79	0.33	0.04
LAB58	35.74	-0.08	-0.01
LAB59	35.96	1.72	0.21
LAB60	35.50*	-2.04	-0.25
LAB61	35.84	0.74	0.09
LAB64	35.82	0.57	0.07
LAB67	35.89	1.14	0.14
LAB68	35.87	0.94	0.12
LAB70	35.74	-0.08	-0.01
LAB71	35.63	-0.95	-0.12
LAB72	35.78	0.25	0.03






LAB73	35.82	0.57	0.07
结果数	61		
总体平均值	35.72		
中位值	35.75		
标准化 IQR	0.12		
稳健 CV (%)	0.34		
最大 值	36.00		
最小值	35.41		
极差	0.59		

注：加 § 号的数值为离群值，即 $|z| \geq 3$ ；加*号的数值为可疑值，即 $2 < |z| < 3$ 。

由于上报时没有说明方法 1 或者方法 2，具体各实验室可以参照 GB/T3884.1-2012 计算，中位值为 35.75 时方法规定的 R 值为 0.28%。各实验室可以根据这个值判定自己实验室是否超差。

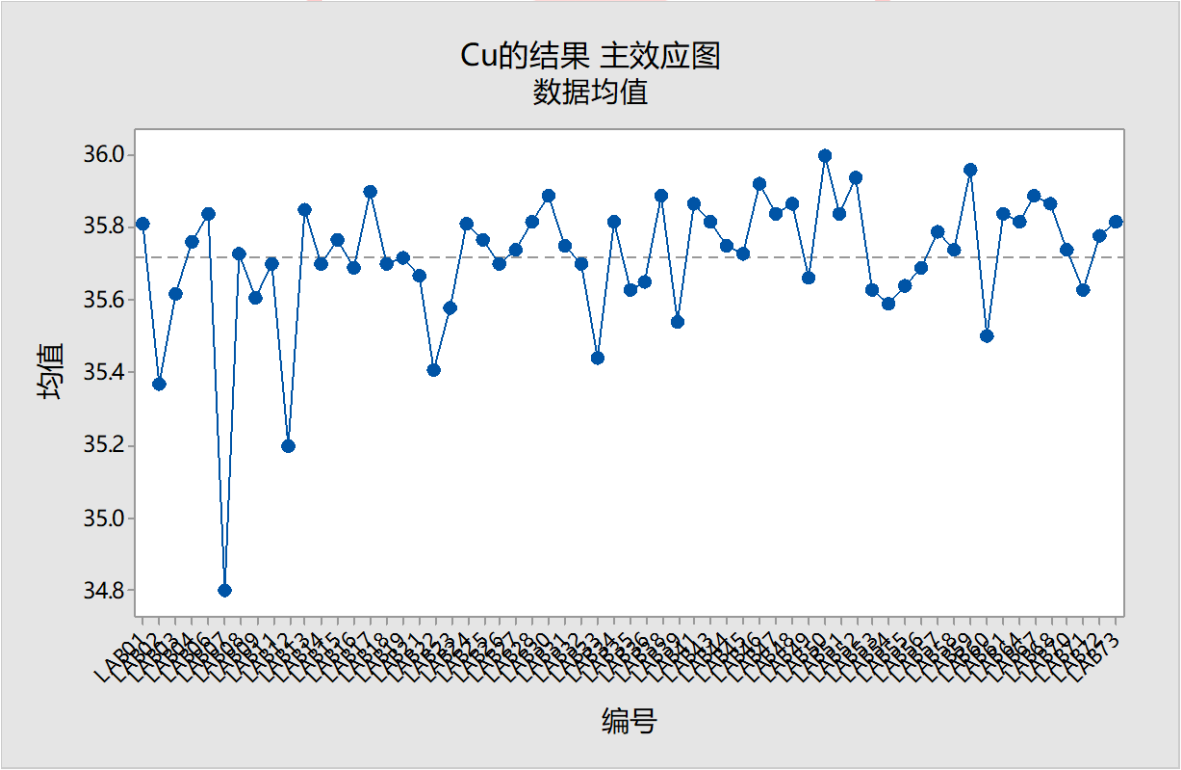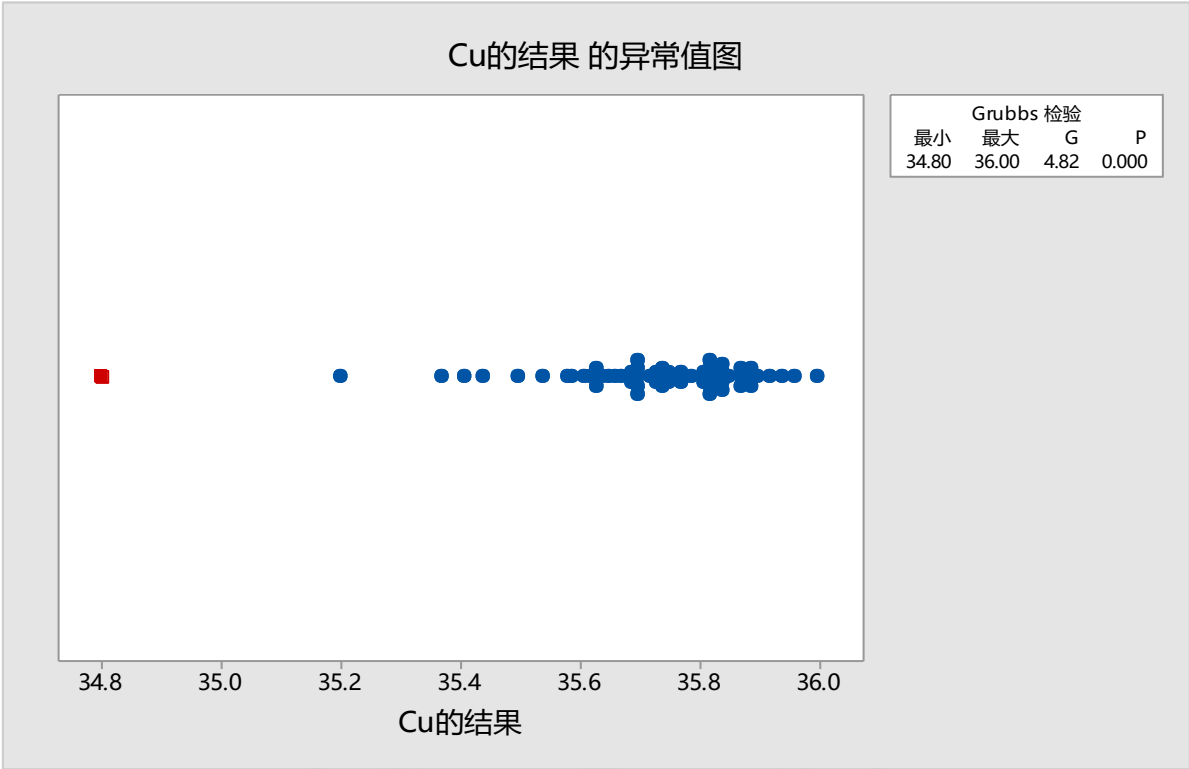

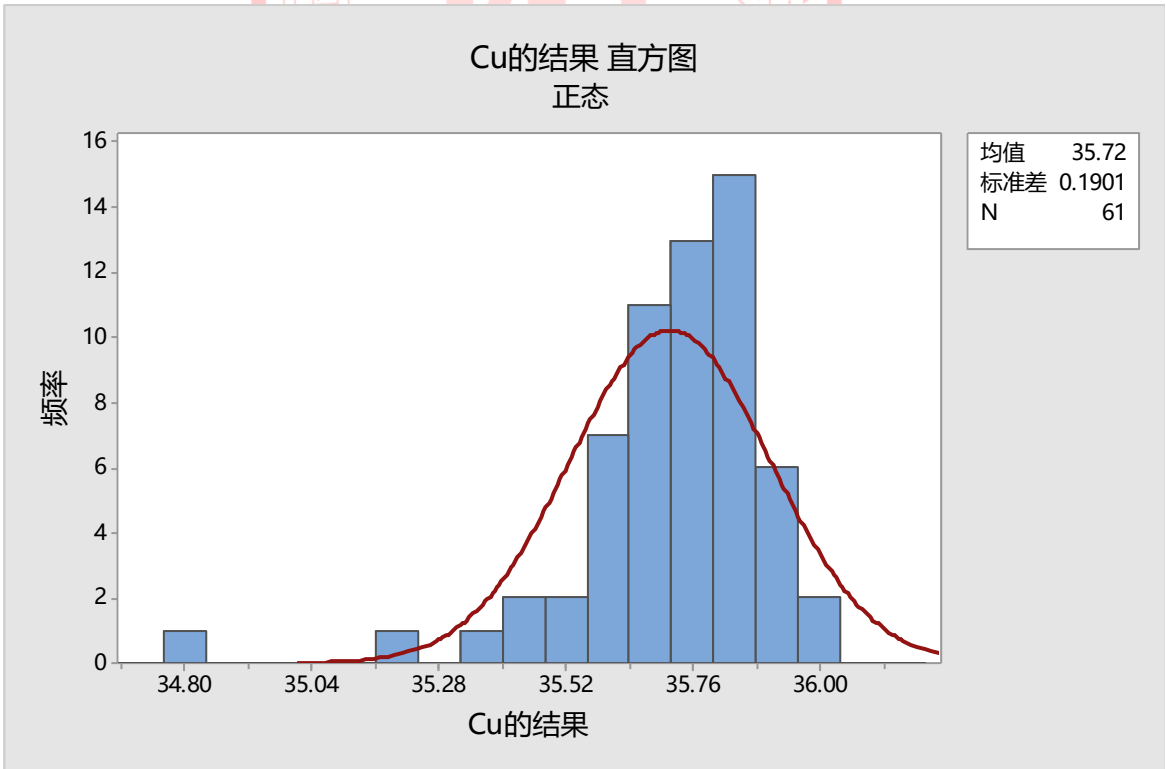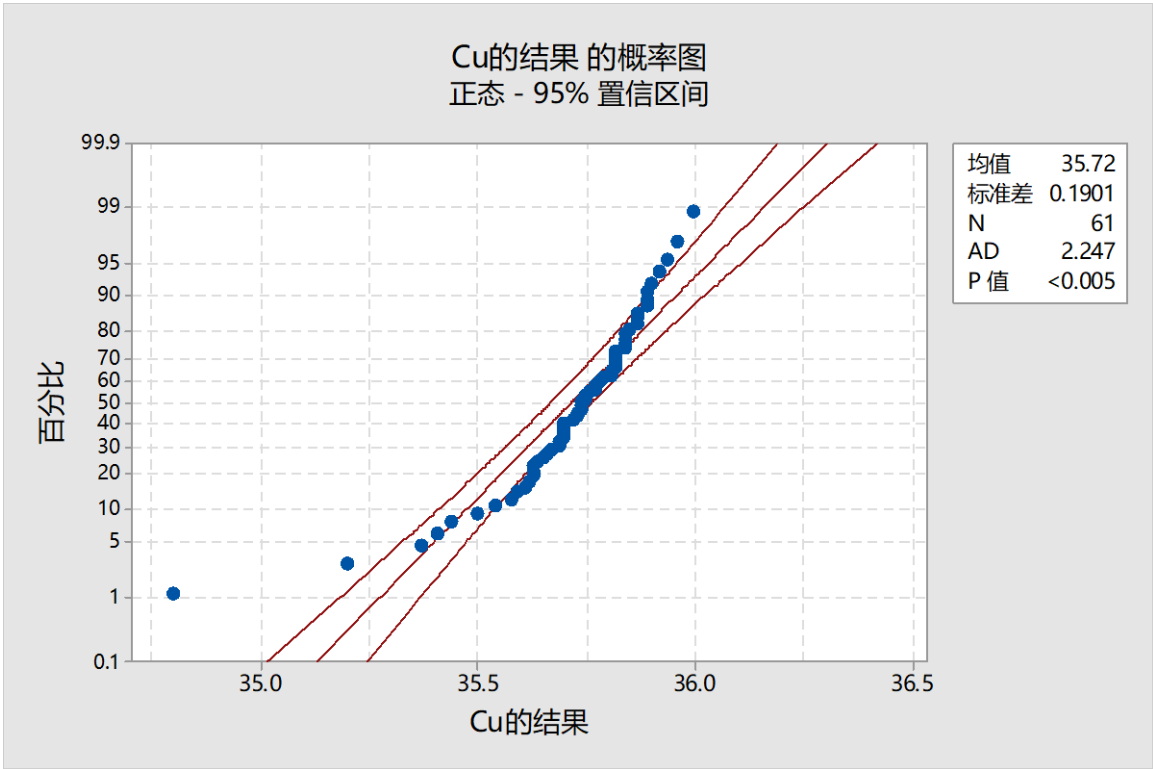

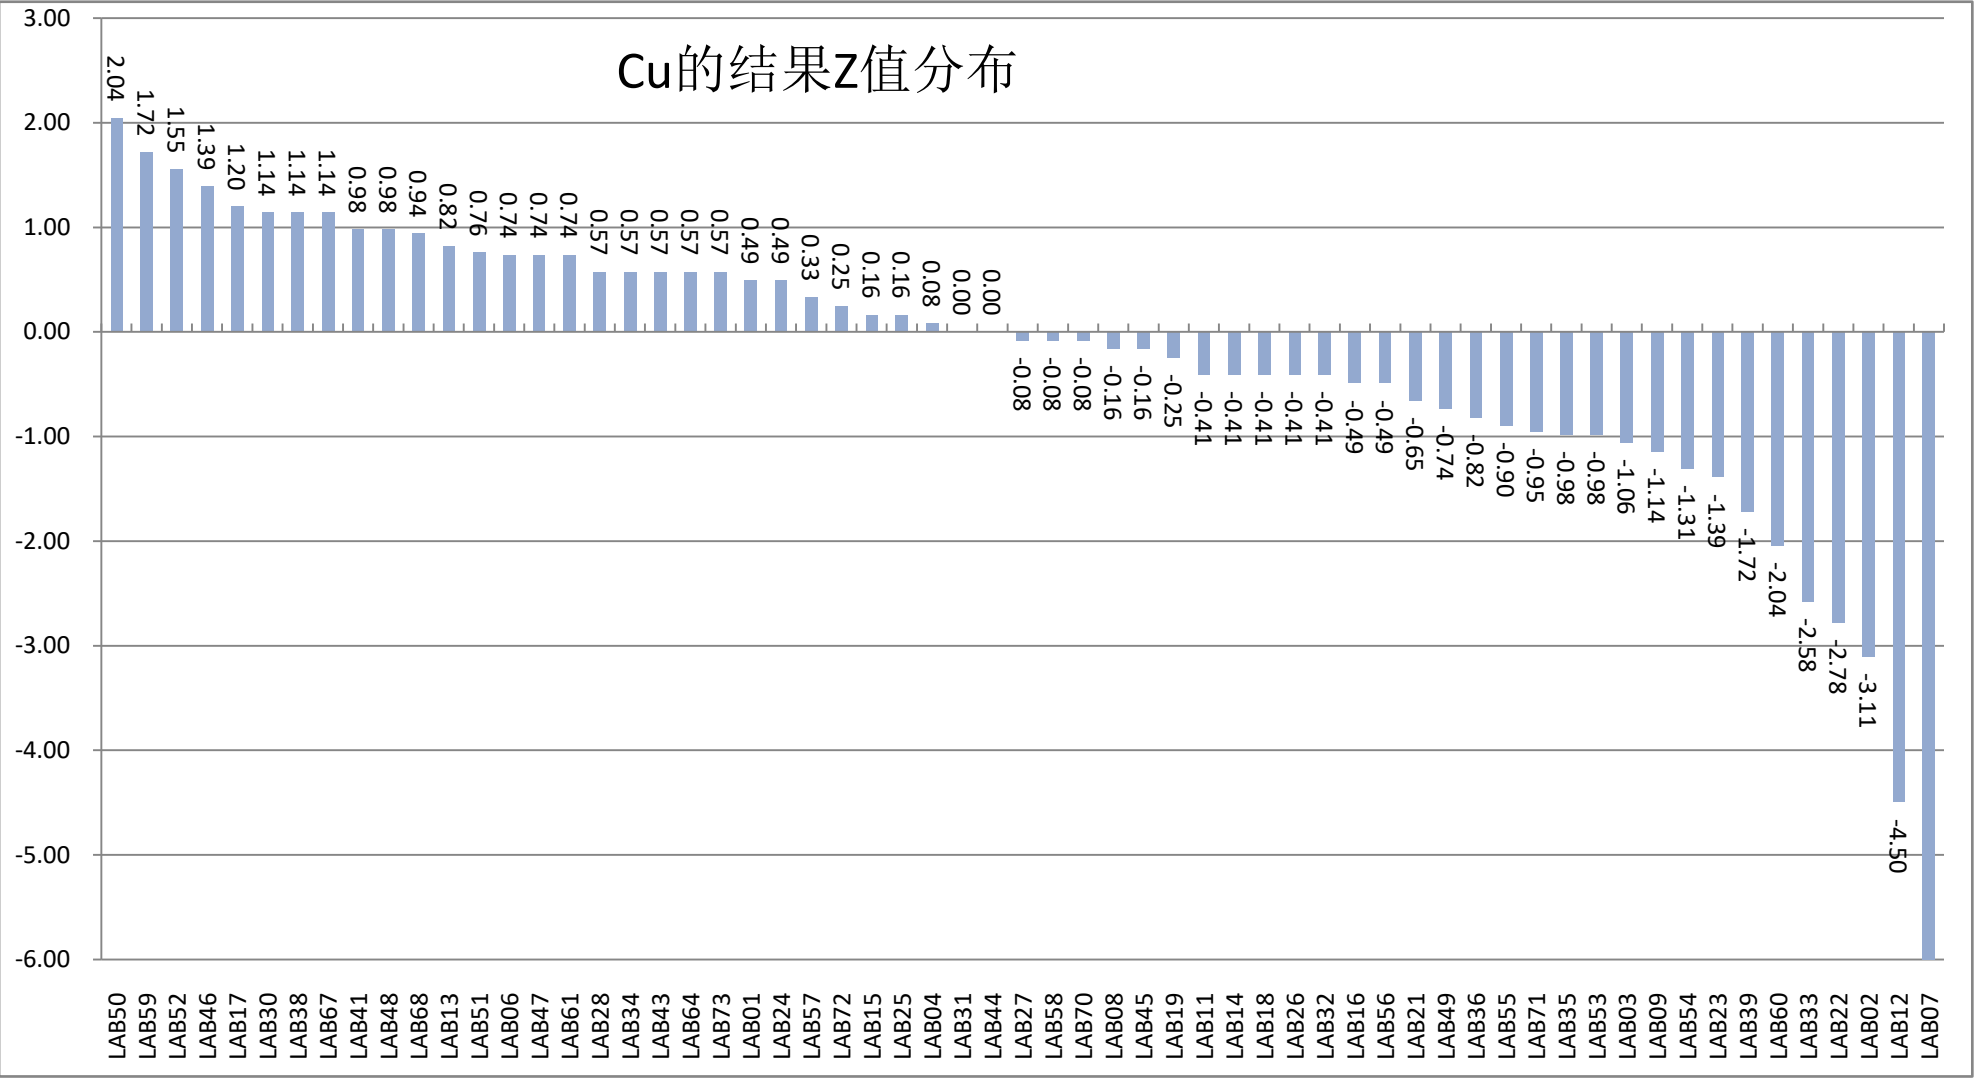



Cu 量分析参与实验室有 61 家， $|Z| < 2$ 的有 54 家， $2 < |Z| < 3$ 的有 4 家， $|Z| \geq 3$ 有 3 家。

58 家采用《GB/T 3884.1-2012 铜精矿化学分析方法 第 1 部分：铜量的测定 碘量法》分析，3 家采用企标分析，方法均为碘量法，方法无差异。

3 Au 的数据分析

实验室编号	平均值/g/t	Z 比分数	与中位值的差，g/t
LAB01	3.43	1.60	0.32
LAB02	2.58*	-2.72	-0.54
LAB03	3.04	-0.38	-0.08
LAB06	3.16	0.23	0.04
LAB07	2.56*	-2.83	-0.56
LAB08	3.10	-0.08	-0.02
LAB09	3.44	1.65	0.33
LAB11	3.43	1.60	0.32
LAB12	2.92	-0.99	-0.20
LAB13	3.12	0.03	0.00
LAB15	3.09	-0.13	-0.03
LAB16	3.17	0.28	0.05
LAB17	3.71 §	3.03	0.60
LAB18	3.10	-0.08	-0.02
LAB19	4.05 §	4.76	0.94
LAB21	3.05	-0.33	-0.07
LAB22	3.45	1.71	0.34
LAB23	2.87	-1.25	-0.25
LAB24	3.13	0.08	0.01



LAB25	3.03	-0.43	-0.09
LAB26	3.20	0.43	0.09
LAB27	3.05	-0.33	-0.07
LAB28	3.18	0.33	0.06
LAB31	3.06	-0.28	-0.06
LAB33	2.90	-1.09	-0.22
LAB34	3.25	0.69	0.14
LAB35	3.07	-0.23	-0.05
LAB36	3.37	1.30	0.26
LAB38	2.87	-1.25	-0.25
LAB39	3.20	0.43	0.09
LAB41	3.32	1.04	0.21
LAB43	3.30	0.94	0.19
LAB44	3.11	-0.03	-0.01
LAB45	3.10	-0.08	-0.02
LAB46	2.94	-0.89	-0.18
LAB47	3.44	1.65	0.33
LAB48	3.59*	2.42	0.48
LAB49	2.95	-0.84	-0.17
LAB50	3.34	1.14	0.22
LAB51	3.02	-0.50	-0.10
LAB52	2.96	-0.79	-0.16
LAB54	3.40	1.45	0.29
LAB55	3.60*	2.47	0.49
LAB56	3.30	0.94	0.19
LAB57	3.20	0.43	0.09
LAB58	3.02	-0.48	-0.10
LAB59	3.30	0.94	0.19
LAB60	2.93	-0.94	-0.19
LAB61	3.08	-0.18	-0.04
LAB64	3.08	-0.18	-0.04
LAB66	2.03 §	-5.52	-1.09




LAB67	3.10	-0.08	-0.02
LAB68	3.38	1.32	0.26
LAB70	2.92	-0.99	-0.20
LAB71	3.12	0.00	0.00
LAB72	3.17	0.29	0.06
LAB73	3.18	0.33	0.06
结果数	57		
总体平均值	3.15		
中位值	3.12		
标准化 IQR	0.196		
稳健 CV (%)	6.306		
最大 值	4.05		
最小值	2.03		
极差	2.02		

注：加 § 号的数值为离群值，即 $|z| \geq 3$ ；加*号的数值为可疑值，即 $2 < |z| < 3$ 。

根据 GB/T 3884.2-2012 中的规定计算再现性限 R，实验室中位值为 3.12g/t 时方法规定的 R 值为 0.69 g/t，各实验室可以根据这个值判定自己实验室是否超差




Au的结果 的异常值图

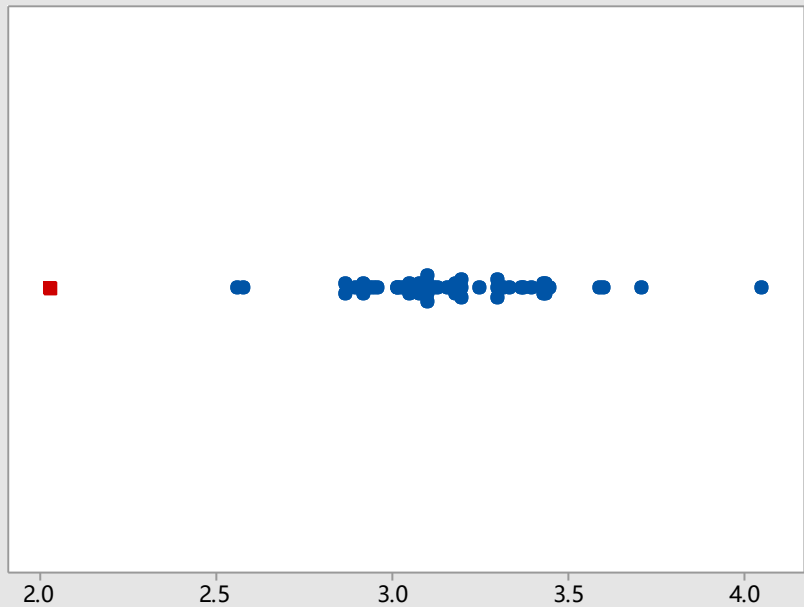

Grubbs 检验			
最小	最大	G	P
2.03	4.05	3.82	0.002



Au的结果


Au的结果 的概率图
正态 - 95% 置信区间

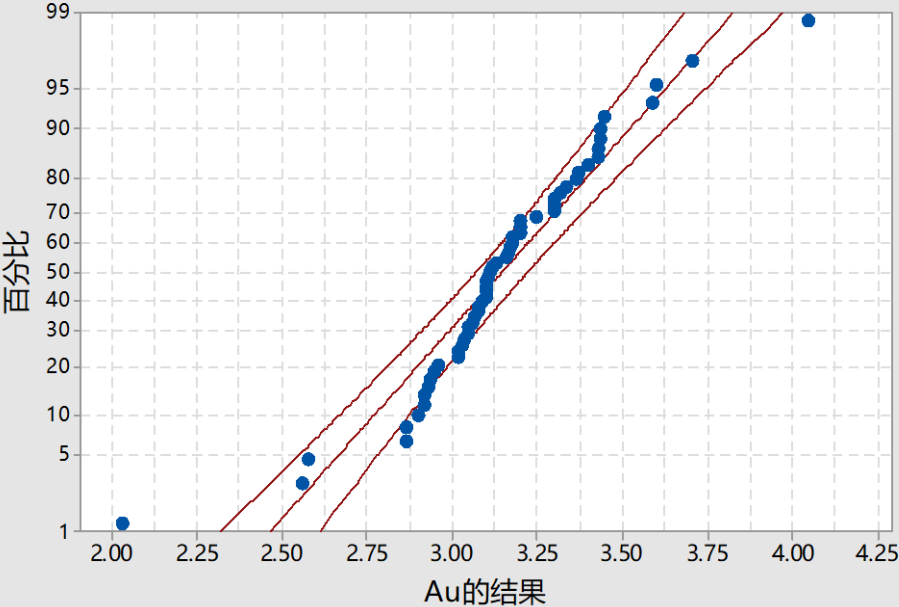

均值	3.148
标准差	0.2925
N	57
AD	1.255
P 值	<0.005

Au的结果

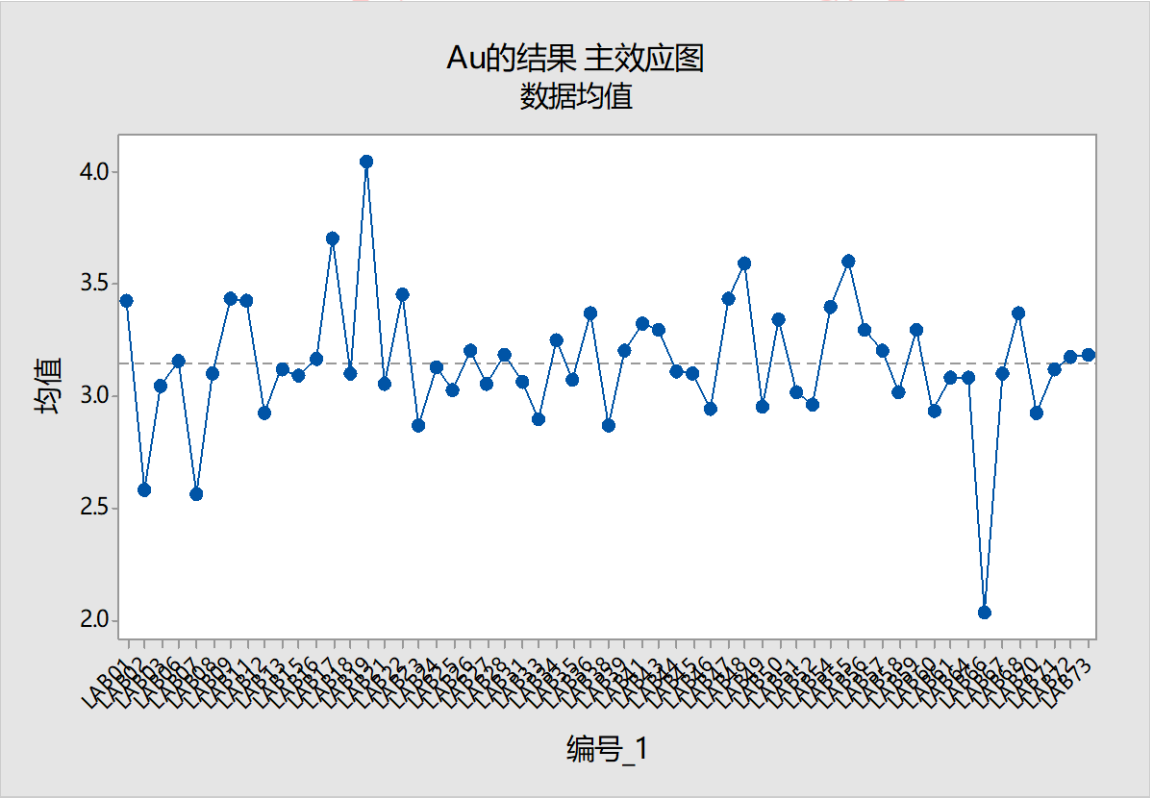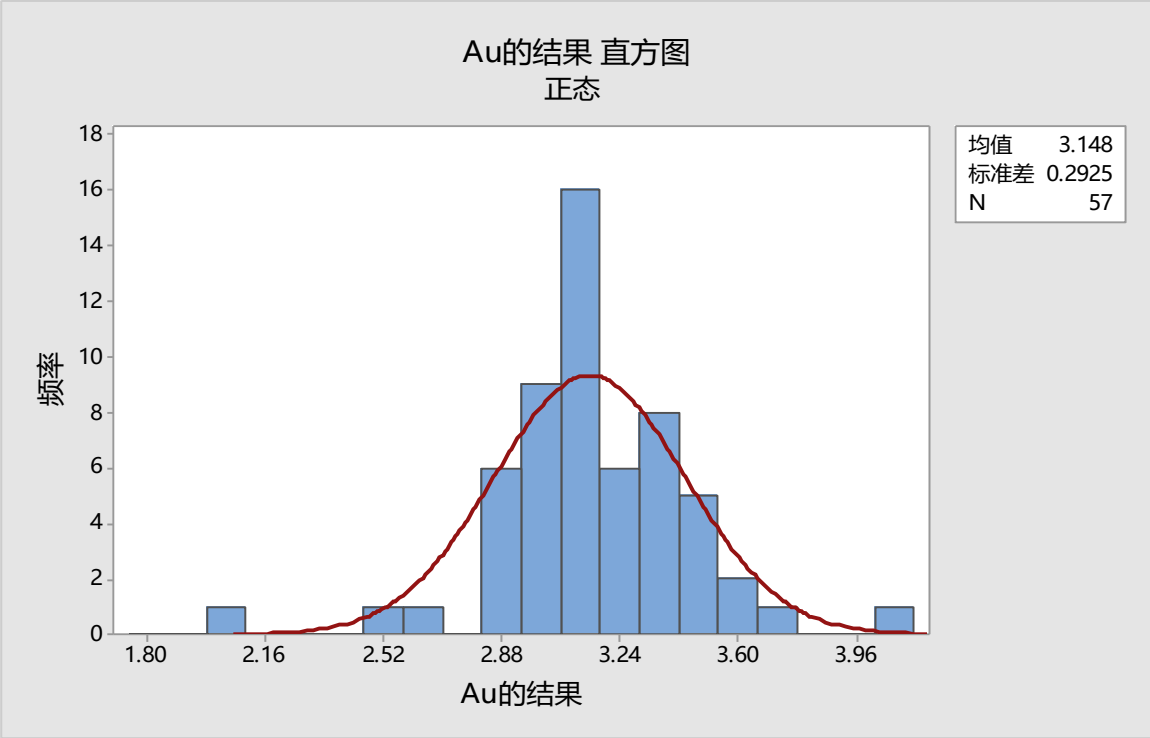

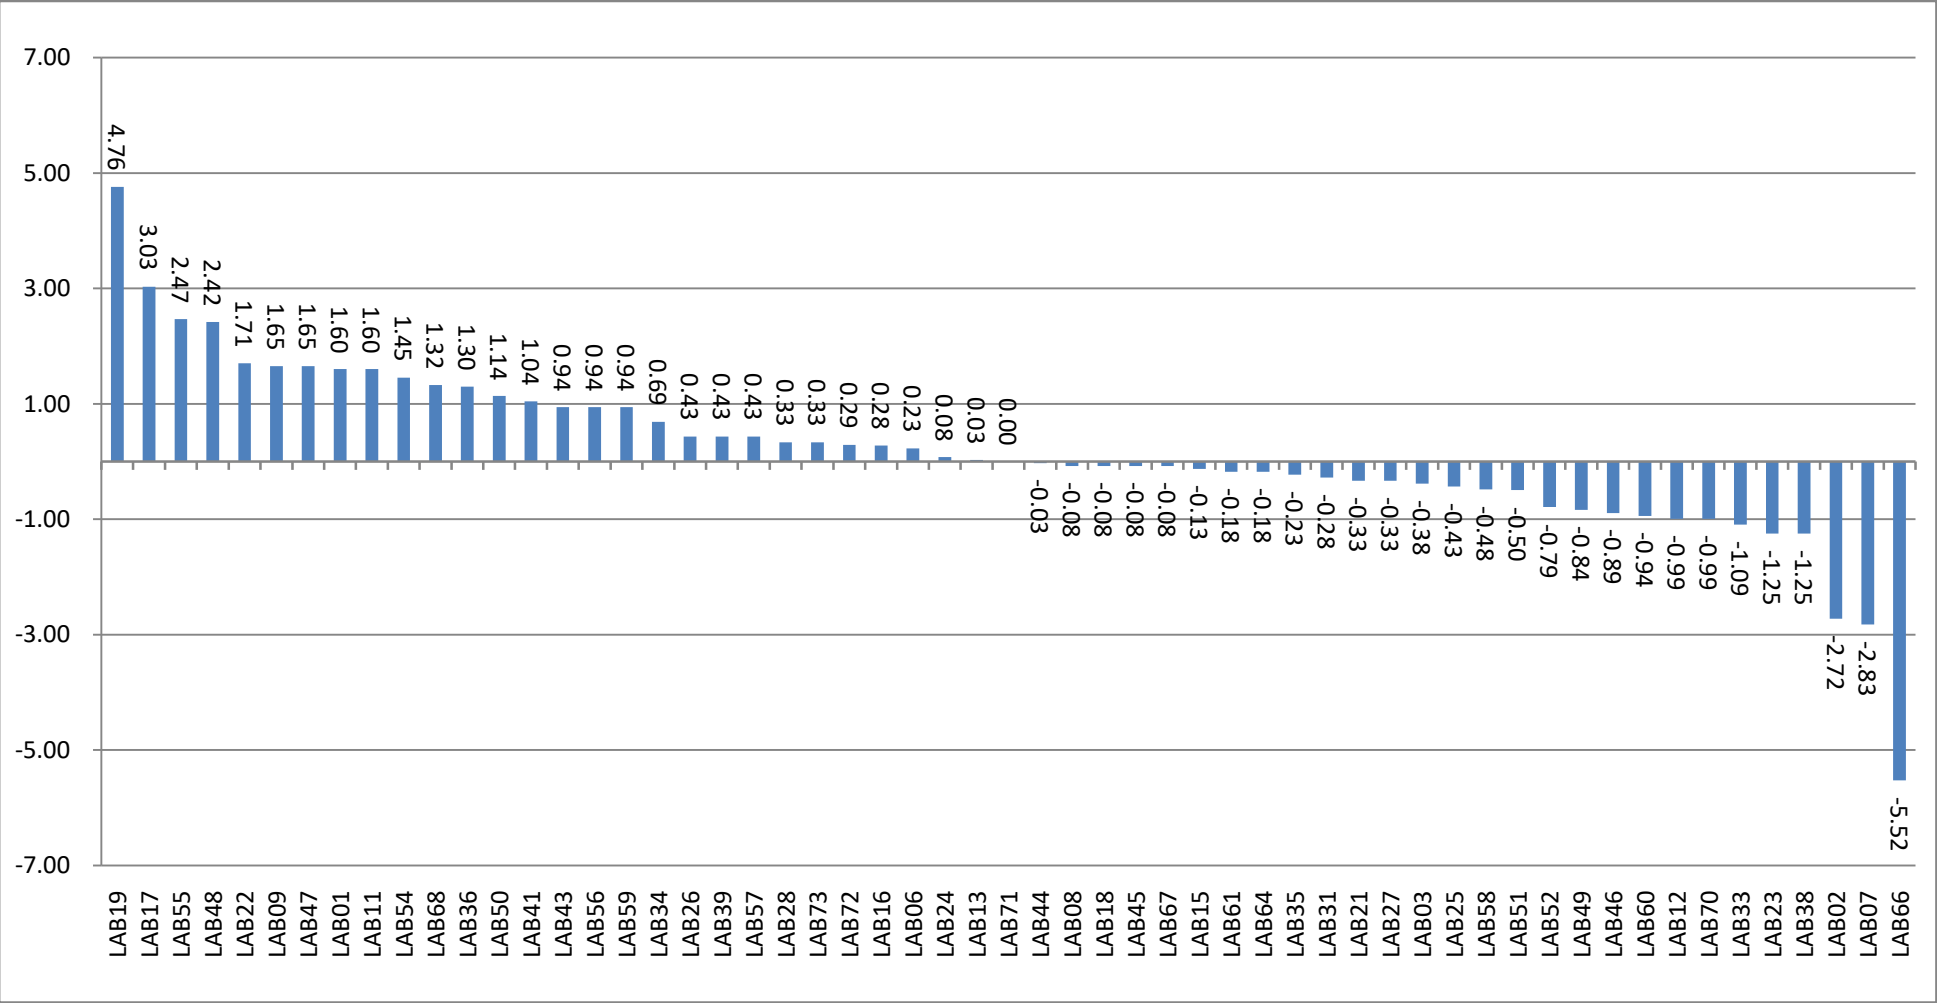

Au 量分析参与实验室有 57 家， $|Z| \leq 2$ 的有 50 家， $2 < |Z| < 3$ 的有 4 家， $|Z| \geq 3$ 有 3 家。

52 家采用《GB/T 3884.2-2012 铜精矿化学分析方法 第 2 部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法》分析，1 家采用《GB/T 3884.14-2012 铜精矿化学分析方法 第 14 部分：金和银量测定 火试金重量法和原子吸收光谱法》，2 家采用 GB/T7739.1-2007，2 家采用企标分析，1 家采用 DZG-93-09 分析。方法均为火试金法和 AAS 法。

4 Ag 的数据分析

实验室编号	平均值/g/t	Z 比分数	与中位值的差, g/t
LAB01	162.9	0.35	1.5
LAB02	157.4	-0.96	-4.0
LAB03	159.8	-0.39	-1.6
LAB06	171.9*	2.46	10.5
LAB07	168.8	1.73	7.4
LAB08	158.3	-0.74	-3.1
LAB09	153.7	-1.82	-7.7
LAB11	164.9	0.82	3.5
LAB12	163.7	0.53	2.3
LAB13	161.2	-0.06	-0.2
LAB14	165.0	0.84	3.6
LAB15	158.4	-0.72	-3.0
LAB16	162.9	0.34	1.5
LAB17	160.9	-0.12	-0.5
LAB18	162.5	0.25	1.1



LAB19	163.0	0.37	1.6
LAB21	161.3	-0.03	-0.1
LAB22	154.0	-1.75	-7.4
LAB23	150.7*	-2.53	-10.7
LAB24	164.1	0.63	2.7
LAB25	159.5	-0.45	-1.9
LAB26	159.5	-0.46	-1.9
LAB27	161.5	0.00	0.1
LAB28	165.3	0.91	3.9
LAB30	161.6	0.02	0.2
LAB31	167.6	1.45	6.2
LAB33	168.0	1.53	6.5
LAB34	157.4	-0.96	-4.0
LAB35	163.0	0.37	1.6
LAB36	165.2	0.88	3.8
LAB38	160.8	-0.15	-0.6
LAB39	157.8	-0.85	-3.6
LAB41	158.6	-0.67	-2.8
LAB43	159.5	-0.47	-2.0
LAB44	170.0*	2.01	8.6
LAB45	165.2	0.88	3.8
LAB46	161.5	0.01	0.1
LAB47	162.4	0.23	1.0
LAB48	160.2	-0.29	-1.2
LAB49	147.8 §	-3.21	-13.6
LAB50	158.4	-0.72	-3.0
LAB51	153.7	-1.82	-7.7
LAB52	165.1	0.86	3.7
LAB53	163.9	0.58	2.5
LAB54	152.1*	-2.20	-9.3
LAB55	170.8*	2.20	9.4
LAB56	164.4	0.70	3.0







LAB57	162.3	0.20	0.9
LAB58	158.6	-0.67	-2.8
LAB59	163.8	0.55	2.4
LAB60	151.4*	-2.37	-10.0
LAB61	158.3	-0.74	-3.1
LAB64	159.8	-0.39	-1.6
LAB66	243.7 §	19.35	82.3
LAB67	149.8*	-2.74	-11.6
LAB68	160.6	-0.20	-0.8
LAB70	165.3	0.91	3.9
LAB71	161.4	0.00	0.0
LAB72	160.8	-0.14	-0.6
LAB73	164.4	0.70	3.0
结果数	60		
总体平均值	162.4	离群值未排除, 参考	
中位值	161.4		
标准化 IQR	4.3		
稳健 CV (%)	2.6		
最大 值	243.7		
最小值	147.8		
极差	95.92		


注: 加 § 号的数值为离群值, 即 $|Z| \geq 3$; 加*号的数值为可疑值,

即 $2 < |Z| < 3$

根据 GB/T 3884.2-2012 中的规定计算再现性限 R, 实验室中位值为 161.4g/t 时方法 1 中 Ag 的 R 值为 14.8g/t, 方法 2 中 Ag 的 R 值为 15.9g/t, 各实验室可以根据这个值判定自己实验室是否超差。

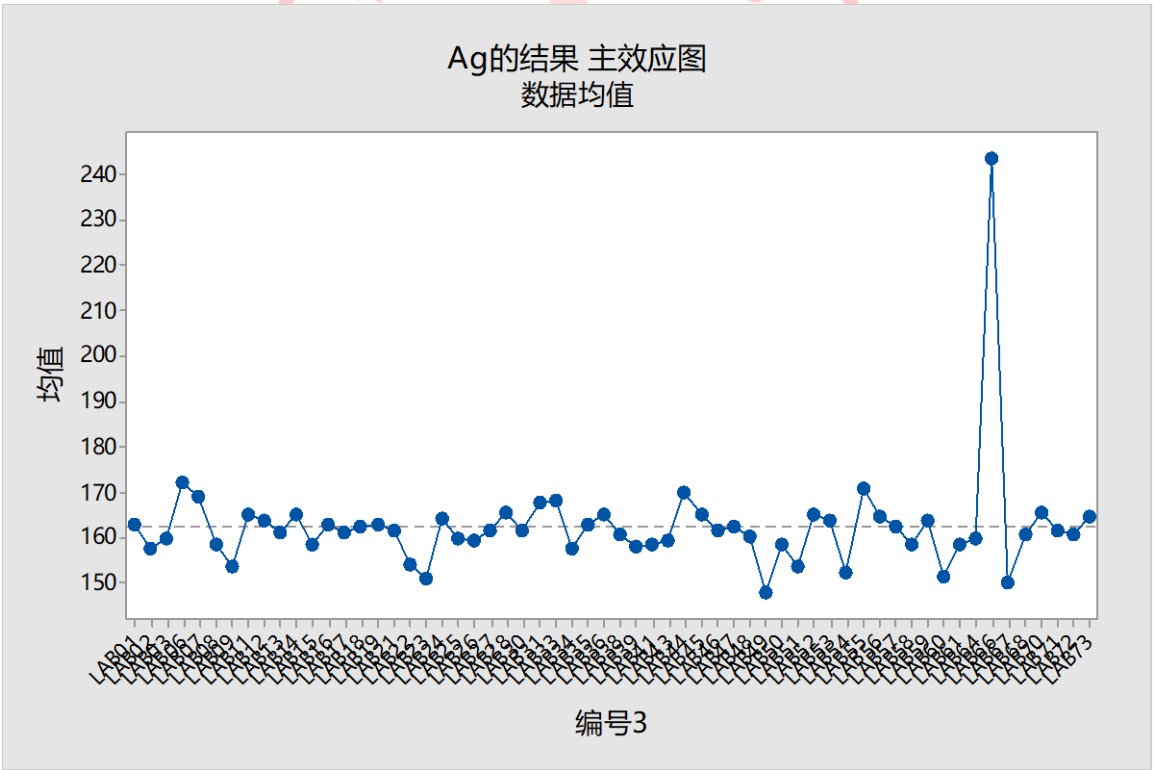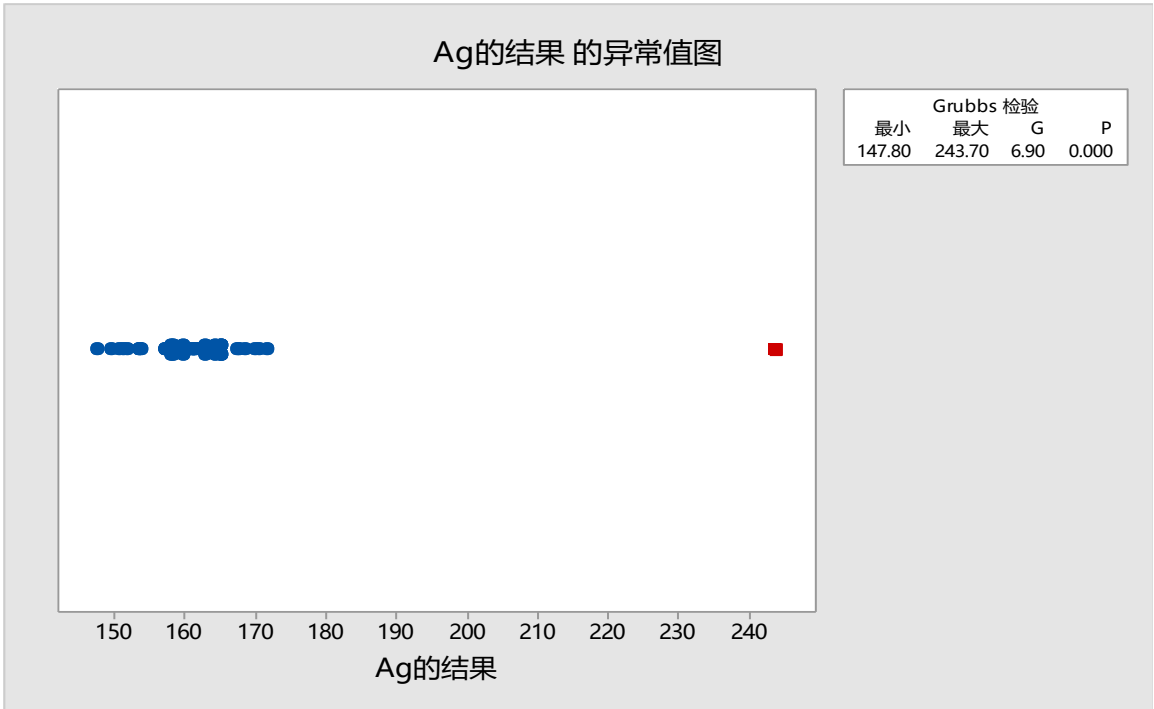

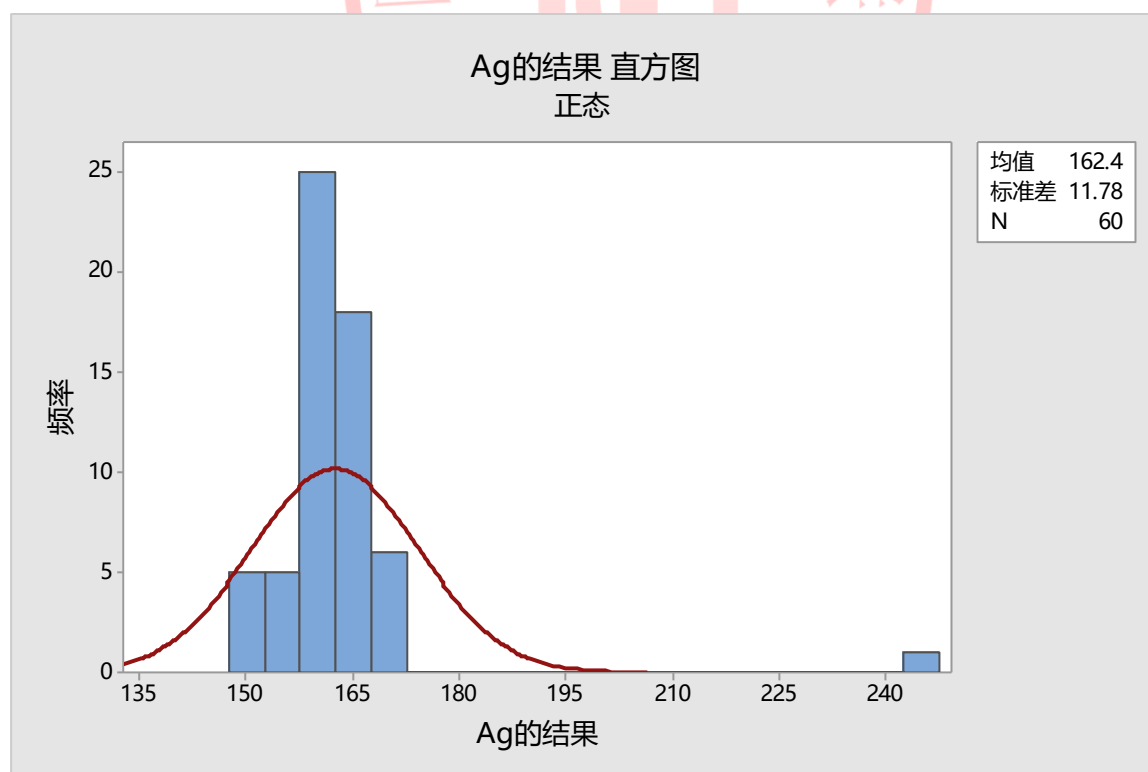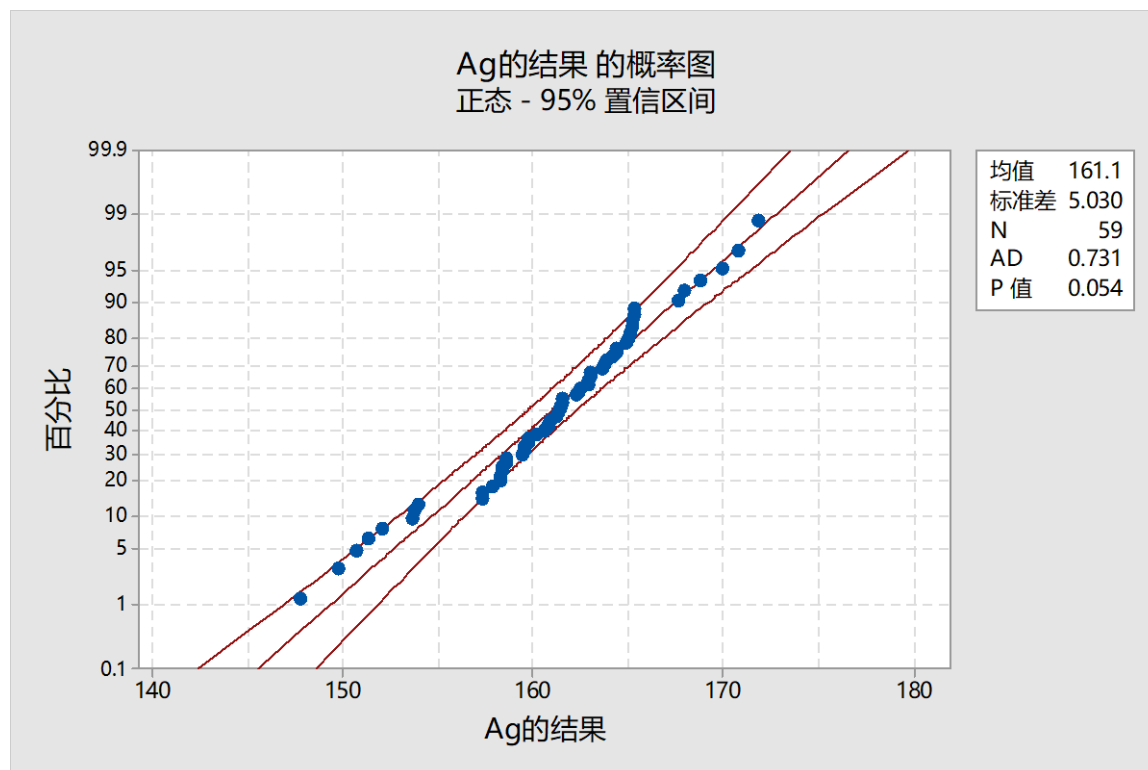

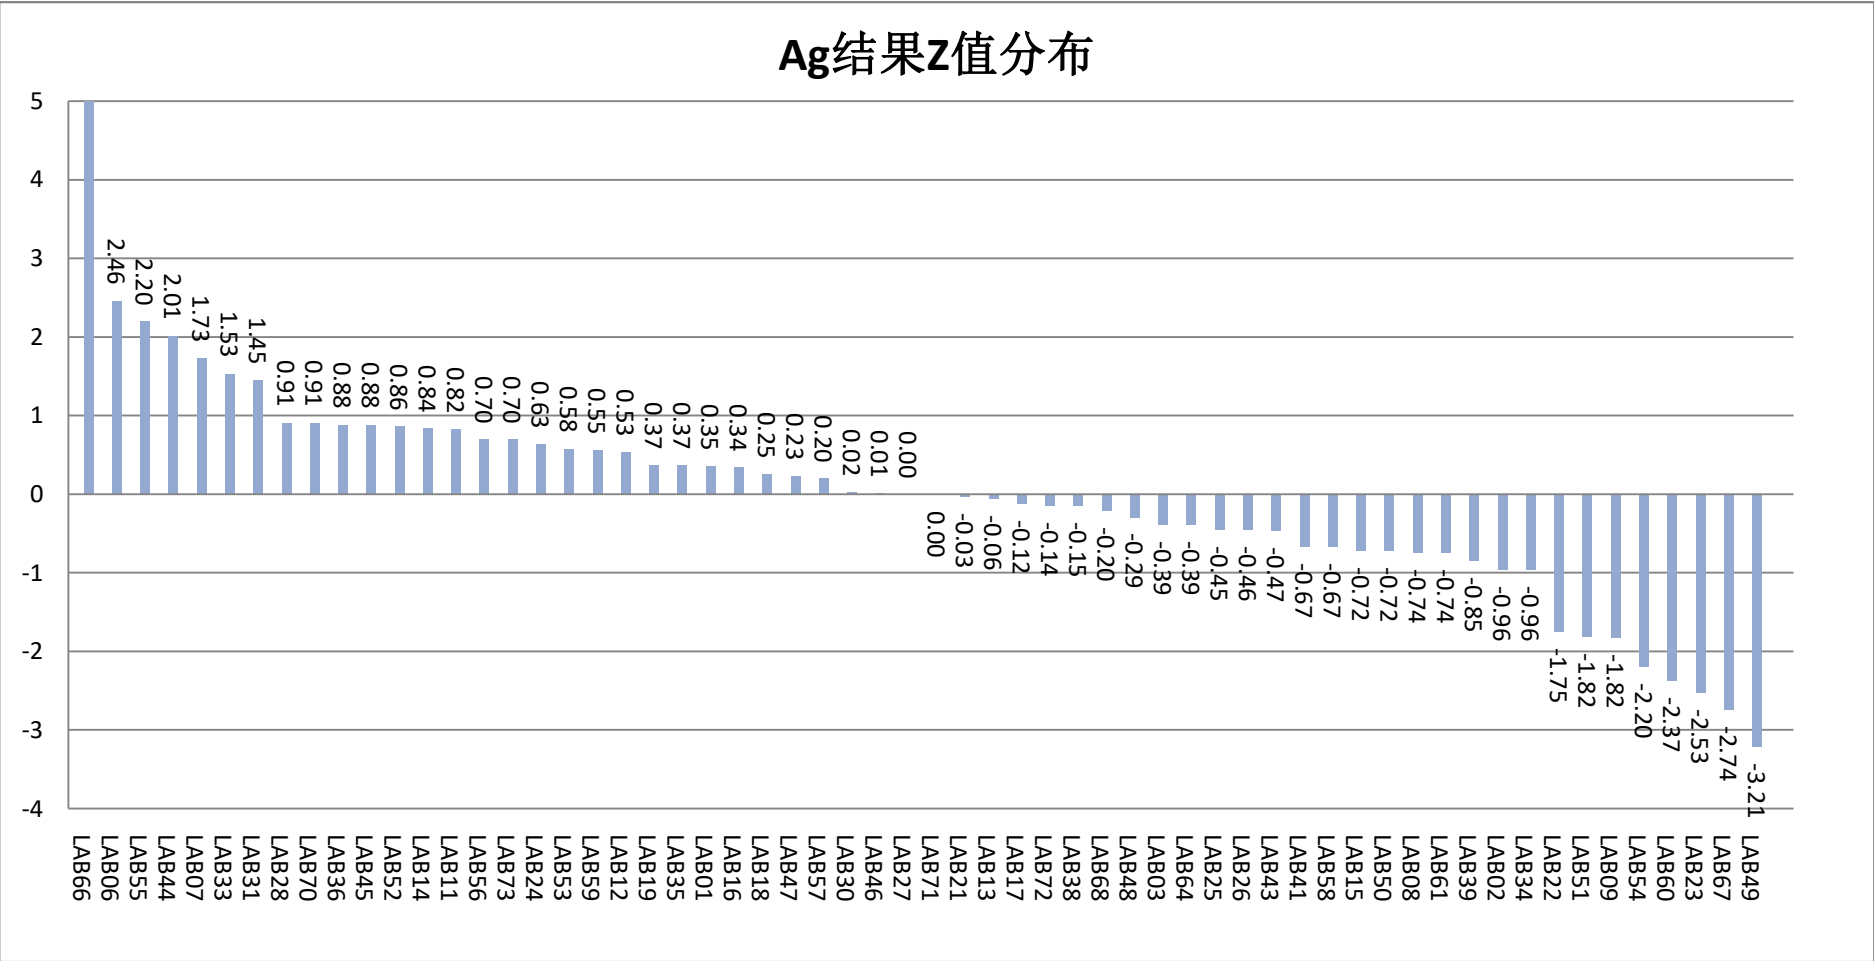



Ag 量分析参与实验室有 60 家， $|z| \leq 2$ 的有 51 家， $2 < |z| < 3$ 的有 7 家， $|z| \geq 3$ 有 2 家。

57 家采用《GB/T 3884.2-2012 铜精矿化学分析方法 第 2 部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法》分析，1 家采用 GB/T7739.1-2007，2 家企标分析，方法均为火试金法和 FAAS 方法，方法无差异。





附录 A 参与单位：（排名按首字拼音顺序）

单位名称
Alfred H Knight International
AHK 检验集团中国天津实验室
Laboratory Services International BV (LSI)
安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心
安徽省有色金属材料质量监督检验站有限公司
巴彦淖尔市紫金矿冶检测技术有限公司
巴彦淖尔西部铜业有限公司质检中心
白银有色集团股份有限公司检测控制中心
北矿检测技术有限公司徐州分所
郴州市金贵银业股份有限公司
赤峰富邦铜业有限责任公司
赤峰云铜有色金属有限公司
楚雄滇中有色金属有限责任公司
大冶有色设计研究院有限公司
东营方圆有色金属有限公司
福建紫金矿冶测试技术有限公司
福建紫金矿冶测试技术有限公司厦门分公司
广西河池市南方有色集团有限公司
广西冶金研究院有限公司
贵研检测科技（云南）有限公司
国家金银及制品质量监督检验中心（长春）
汉中锌业有限责任公司
河南省黄金贵金属产品质量监督检验中心
河南豫光金铅股份有限公司检测中心
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司研发中心
湖南金旺铋业股份有限公司
湖南省硕远检测技术有限公司
湖南有色金属研究院分析测试所
济源市万洋冶炼（集团）有限公司
江铜贵冶中心化验室
江西新金叶实业有限公司
金川集团股份有限公司检测中心
金隆铜业有限公司化验中心
连云港出入境检验检疫局 化矿实验室
凉山矿业股份有限公司
辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司
内蒙古乌拉特后旗紫金矿业有限公司
山东国大黄金股份有限公司
山东恒邦冶炼股份有限公司中心化验室
上海英斯贝克商品检验有限公司金属矿产实验室
韶关冶炼厂质控车间



水口山有色金属有限责任公司
通标标准技术服务（天津）有限公司
铜陵出入境检验检疫局铜原料及产品检测实验室
铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司
西藏玉龙铜矿股份有限公司
烟台国润铜业有限公司
阳谷祥光铜业有限公司分析测试中心
易门铜业有限公司
有色金属桂林矿产地质测试中心
云南华联锌铟股份有限公司
云南铜业股份有限公司检验分析中心
云南锡业矿冶检测中心
长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心
浙江富冶集团有限公司检测中心
中国检验认证集团广西有限公司综合实验室
中矿（天津）岩矿检测有限公司
中条山集团山西有色金属检测有限公司
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司检测中心
株冶集团质量检测中心
紫金铜业有限公司
北矿检测技术有限公司



附录 B 山东祥光集团分析测试中心铜精矿样品均匀性检验报告

实验单位：山东祥光集团分析测试中心

日期：2017.4.6-4.15

实验过程：将制备好的铜精矿样品随机取 10 个样，每个样测定 Cu、Au、Ag 含量，重复测定 2 次，进行样品均匀性检验。

实验结果：

(1) Cu 的测定

水平 j	Cu 测定值 x_{ij}		$\bar{x}_i$	$\sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$\bar{x}$	$n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$
1	35.77	35.73	35.750	0.00080	35.79	0.00328
2	35.78	35.84	35.810	0.00180		0.00076
3	35.83	35.79	35.810	0.00080		0.00076
4	35.84	35.78	35.810	0.00180		0.00076
5	35.80	35.84	35.820	0.00080		0.00174
6	35.77	35.72	35.745	0.00125		0.00414
7	35.84	35.80	35.820	0.00080		0.00174
8	35.73	35.70	35.715	0.00045		0.01140
9	35.73	35.86	35.795	0.00845		0.00004
10	35.86	35.80	35.830	0.00180		0.00312

$m=10$ 水平，每个水平做 $n=2$ 次，共 20 个数据， $N=20$ 。

自由度 $f_1=m-1=10-1=9$, $f_2=N-m=20-10=10$

$$\text{样品间平方和 } SS_1 = \sum_{i=1}^m n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 0.0277$$

$$\text{均方 } MS_1 = \frac{SS_1}{f_1} = 0.0031$$

$$\text{样品内平方和 } SS_2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = 0.0188$$

$$\text{均方 } MS_2 = \frac{SS_2}{f_2} = 0.00188$$

$$\text{统计量: } F = \frac{MS_1}{MS_2} = 1.64$$

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 临界值 $F_{0.05}(9,10) = 3.02$

本实验 $F < F_{0.05}(9,10)$, 所以整批样品铜的检测结果不存在显著性差异, 是均匀的。

(2) Au 的测定

水平 j	Au 测定值 x_{ij}		$\bar{x}_i$	$\sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$\bar{x}$	$n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$
1	3.19	3.35	3.270	0.01280	3.136	0.0362
2	3.39	2.93	3.160	0.10580		0.0012
3	3.28	3.26	3.270	0.00020		0.0362
4	3.05	2.97	3.010	0.00320		0.0315
5	3.10	2.98	3.040	0.00720		0.0182
6	3.27	3.03	3.150	0.02880		0.0004
7	3.01	3.05	3.030	0.00080		0.0223
8	2.93	3.32	3.125	0.07605		0.0002
9	3.05	3.37	3.210	0.05120		0.0111
10	3.22	2.96	3.090	0.03380		0.0041

$$\text{按上述方法计算样品间平方和 } SS_1 = \sum_{i=1}^m n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 0.161$$

$$\text{均方 } MS_1 = 0.48/9 = 0.0179$$

$$\text{样品内平方和 } SS_2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = 0.32$$

$$\text{均方 } MS_2 = 0.32/10 = 0.032$$

$$\text{统计量: } F = \frac{MS_1}{MS_2} = 0.56$$

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 临界值 $F_{0.05}(9,10) = 3.02$

本实验 $F < F_{0.05}(9,10)$, 所以整批样品金的检测结果不存在显著性差异, 是均匀的。

(3) Ag 的测定:

水平 j	Ag 测定值 x_{ij}		$\bar{x}_i$	$\sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$\bar{x}$	$n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$
1	162.7	160.9	161.800	1.62000	162.025	0.1012
2	162.2	162.5	162.350	0.04500		0.2113
3	161.1	161.9	161.500	0.32000		0.5512
4	161.3	160.8	161.050	0.12500		1.9012
5	162.1	162.0	162.050	0.00500		0.0013
6	161.9	162.2	162.050	0.04500		0.0013
7	162.0	163.0	162.500	0.50000		0.4513
8	162.0	162.5	162.250	0.12500		0.1013
9	162.1	163.0	162.550	0.40500		0.5513
10	161.7	162.6	162.150	0.40500		0.0313

$$\text{按上述方法计算样品间平方和 } SS_1 = \sum_{i=1}^m n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 3.90$$

$$\text{均方 } MS_1 = 3.90/9 = 0.43$$

$$\text{样品内平方和 } SS_2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = 3.60$$

$$\text{均方 } MS_2 = 3.60/10 = 0.36$$

$$\text{统计量: } F = \frac{MS_1}{MS_2} = 1.20$$

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 临界值 $F_{0.05}(9,10) = 3.02$

本实验 $F < F_{0.05}(9,10)$, 所以整批样品银的检测结果不存在显著性差异, 是均匀的。

祥光铜业有限公司分析测试中心



附录 C 北矿检测技术有限公司 2017 年铜精矿样品均匀性检验报告

测试单位：北矿检测技术有限公司

测试日期：2016.4.2-2016.4.12

样品提供单位：祥光铜业

样品数量：10 份

测定方法：每个样品用碘量法测定 Cu 的含量，用火试金法测定 Au 含量、银含量，用原子吸收光谱法测定银含量，平行测定两次，进行样品均匀性检验。

1 Cu 的测定

水平 j	Cu 测定值 x_{ij}		$\bar{x}_i$	$\sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$\bar{x}$	$n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$
1	35.75	35.71	35.73	0.00080	35.78	0.005
2	35.8	35.67	35.74	0.00845		0.00405
3	35.85	35.77	35.81	0.00320		0.0018
4	35.78	35.71	35.75	0.00245		0.00245
5	35.73	35.78	35.76	0.00125		0.00125
6	35.77	35.86	35.82	0.00405		0.00245
7	35.86	35.88	35.87	0.00020		0.0162
8	35.69	35.8	35.75	0.00605		0.00245
9	35.78	35.85	35.82	0.00245		0.00245
10	35.72	35.84	35.78	0.00720		0

$m=10$ 水平，每个水平做 $n=2$ 次，共 20 个数据， $N=20$ 。

自由度 $f_1=m-1=9$, $f_2=N-m=20-10=10$

$$\text{样品间平方和 } SS_1 = \sum_{i=1}^m n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 0.0381$$

$$\text{均方 } MS_1 = \frac{SS_1}{f_1} = 0.0042$$

$$\text{样品内平方和 } SS_2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = 0.0361$$

$$\text{均方 } MS_2 = \frac{SS_2}{f_2} = 0.0018$$

$$\text{统计量: } F = \frac{MS_1}{MS_2} = 2.34$$

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 临界值 $F_{0.05}(9,10) = 3.02$

本实验 $F < F_{0.05}(9,10)$, 所以整批样品铜的检测结果不存在显著性差异, 是均匀的。

2 Au 的测定

水平 j	Au 测定值 x_{ij}		$\bar{x}_i$	$\sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$\bar{x}$	$n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$
1	3.29	3.43	3.36	0.00980	3.17	0.0718
2	3.29	3.16	3.23	0.00845		0.0059
3	3.16	3.23	3.20	0.00245		0.0012
4	3.03	2.96	3.00	0.00245		0.0616
5	3.16	3.29	3.23	0.00845		0.0059
6	3.03	3.16	3.10	0.00845		0.0114
7	3.29	2.83	3.06	0.10580		0.0244
8	3.16	3.16	3.16	0.00000		0.0002
9	3.03	3.23	3.13	0.02000		0.0033
10	3.09	3.43	3.26	0.05780		0.0160

$m=10$ 水平, 每个水平做 $n=2$ 次, 共 20 个数据, $N=20$ 。

自由度 $f_1=m-1=9$, $f_2=N-m=20-10=10$

$$\text{样品间平方和 } SS_1 = \sum_{i=1}^m n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 0.2018$$

$$\text{均方 } MS_1 = \frac{SS_1}{f_1} = 0.0224$$

$$\text{样品内平方和 } SS_2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = 0.2237$$

$$\text{均方 } MS_2 = \frac{SS_2}{f_2} = 0.0224$$

$$\text{统计量: } F = \frac{MS_1}{MS_2} = 1.00$$

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 临界值 $F_{0.05}(9,10) = 3.02$

本实验 $F < F_{0.05}(9,10)$, 所以整批样品金的检测结果不存在显著性差异, 是均匀的。

3 Ag 的测定:

水平 j	Ag 测定值 x_{ij}		$\bar{x}_i$	$\sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$\bar{x}$	$n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$
1	164.0	156.0	160.0	32.0	160.9	1.62
2	163.0	159.0	161.0	8.0		0.02
3	162.0	160.0	161.0	2.0		0.02
4	166.0	161.0	163.5	12.5		13.52
5	166.0	157.0	161.5	40.5		0.72
6	164.0	156.0	160.0	32.0		1.62
7	163.0	162.0	162.5	0.5		5.12
8	161.0	157.0	159.0	8.0		7.22
9	161.0	161.0	161.0	0.0		0.02
10	166.0	153.0	159.5	84.5		3.92

$m=10$ 水平, 每个水平做 $n=2$ 次, 共 20 个数据, $N=20$ 。

自由度 $f_1=m-1=9$, $f_2=N-m=20-10=10$

$$\text{样品间平方和 } SS_1 = \sum_{i=1}^m n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 33.8$$

$$\text{均方 } MS_1 = \frac{SS_1}{f_1} = 3.756$$

$$\text{样品内平方和 } SS_2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = 220$$

$$\text{均方 } MS_2 = \frac{SS_2}{f_2} = 22$$

$$\text{统计量: } F = \frac{MS_1}{MS_2} = 0.17$$

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 临界值 $F_{0.05}(9,10) = 3.02$

本实验 $F < F_{0.05}(9,10)$, 所以整批样品银的检测结果不存在显著性差异, 是均匀的。

北矿检测技术有限公司

2017.5.10

附录 D 统计分析有关统计量的意义及其计算方法

对本次循环比对计划实验室的检测结果，按下式计算 Z 比分值：

$$Z=(x-X)/\sigma$$

式中：x-实验室测试结果；

X-指定值；

σ -变动性度量值（目标标准偏差）。

本次循环比对计划统计分析采用稳健（Robust）技术处理，以稳健平均值作为指定值，稳健标准差为变动性度量值（目标标准偏差），计算各实验室结果的 Z 比分数（Z 值），同时给出稳健平均值的标准不确定度。

1. 稳健平均值的计算

本次循环比对各子项目的测定结果，根据 ISO13528: 2005《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》，对稳健平均值进行了统计计算，同时给出了循环比对结果的标准不确定度，供各实验室参考。

1) 稳健平均值 x^* 和稳健标准差 s^* 初始值的计算

有 p 个数，按从小到大顺序排列： $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_p$

用 x^* 和 s^* 代表稳健平均值和稳健标准差，计算 x^* 和 s^* 的初始值：

$$x^*=x_i \text{ 的中位值 } (i=1, 2, \dots, p)$$

$$s^*=1.483|x_i - x^*| \text{ 的中位值 } (i=1, 2, \dots, p)$$

2) 对 x^* 和 s^* 的修正

计算 $\delta=1.5 s^*$

对于每个 $x_i (i=1, 2, \dots, p)$ 计算如下：

$$x_i^* = \begin{cases} x^* - \delta, & x_i < x^* - \delta \\ x^* + \delta, & x_i > x^* + \delta \\ x_i, & \text{介于两者之间} \end{cases}$$

由下式计算 x^* 和 s^* 的新值：

$$x^* = \sum x_i^* / p$$

$$s^* = 1.134 \sqrt{\sum (x_i^* - x^*)^2 / (p - 1)}$$

稳健平均值 x^* 和 s^* 通过迭代计算得出，如，用校正后的数据对 x^* 和 s^* 进行多次修正，直到迭代后稳健标准差 s^* 和稳健平均值 x^* 的第三位有效数字没有变化为止。

2. 循环比对计划涉及的其他统计量

依据 CNAS-GL02 《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》，本次循环比对涉及的其他统计量，如：结果总数，最大值，最大值和极差，其含义如下：

- **结果总数**—— 在统计分析中某项测定结果的总数。
- **最大值**—— 一组结果中的最大值。
- **最小值**—— 一组结果中的最小值。
- **极差**—— 最大值减最小值。



附录 E 循环比对计划作业指导书

中国矿冶检测机构联盟 循环比对计划作业指导书

实验室名称:

本次样品循环比对计划中, 贵实验室的代码为: LAB***

为保证样品比对计划的顺利进行, 特要求参加单位认真遵循下列条款:

1. 样品

此次比对共有 5 个样品, 各实验室根据报名参加情况, 核对样品含量范围:

铜精矿		铜精矿 (高金)		铅精矿		铅精矿 (高银)		锌精矿	
Cu	32-37%	Cu	13-17%	Pb	42-48%	Pb	50-55%	Zn	48-52%
Au	2-5g/t	Au	25-35g/t	Au	1.5-4g/t	Au	2-5g/t	Cd	0.2-0.5%
Ag	130-200g/t	Ag	50-80g/t	Ag	950-1200g/t	Ag	6000-7000g/t	Ag	130-200g/t

所有样品均为铝膜真空包装, 贴有联盟样品唯一标识。实验室在收到样品后, 首先对样品是否完整确认, 填写样品接收状态确认表中, 将信息发送到 bkceshi@bgrimm.com。

2. 检测

在 100-105℃ 条件下烘 1h 后置于干燥器中, 冷至室温; 各实验室应在重复性条件下测定样品中各元素; 提供方法的名称和编号, 企业内部方法请注明。

3. 结果反馈

1) Cu、Pb、Zn、Cd 结果以质量百分数报出, 实验室对每个测试项目测试 2 次以上, 同时计算平均结果。有效数字规定报出: xx.xx%, x.xx%, 0.xxx%, 0.0xxx%。

2) Au、Ag 结果以 g/t 形式报出, 实验室对每个测试项目测试 2 次以上, 同时计算平均结果。有效数字规定报出: Au 结果小数点后二位 x.xxg/t, Ag 结果小数点后一位 x.xg/t。

3) 实验室结果反馈途径: 电子版报告最迟在 2017 年 7 月 1 日之前报结果报告表寄给联盟秘书处, 同时发送电子版至 bkceshi@bgrimm.com, 报告日期以寄出为准, 无故未按期提交结果的实验室, 其结果将不列入统计。

4) 有关资料电子版请在 <http://www.analysis-bgrimm.com> 上下载。

4. 保密

比对为联盟循环比对, 为各实验室真实情况反应, 严禁互相串通结果。

联络方式: 北京市大兴区北兴路东段 22 号院 1 号楼 A702 室, 邮编 102628

电话: 010-59069658 Email: bkceshi@bgrimm.com

网址: <http://www.analysis-bgrimm.com>

中国矿冶检测机构联盟
2017-05-10

中国矿冶检测机构联盟简介



中国矿冶检测机构联盟由国家重有色金属质量监督检验中心(北京矿冶研究总院测试所/北矿检测技术有限公司)、国家钢铁材料测试中心(国家钢铁产品质量监督检验中心、国家冶金工业钢材无损检测中心、钢研纳克检测技术有限公司)、国家金银及制品质量监督检验中心(长春)(长春黄金研究院检测中心)、国家矿物及再生金属材料质量监督检验中心(广州有色金属研究院分析测试中心、广东省有色金属产品质量监督检验站、广东省金属材料综合利用检测与评价中心、中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心)、国家轻金属质量监督检验中心(郑州轻金属研究院检测实验室、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司质检中心)、北京有色金属与稀土应用研究所(北京市冶金产品质量监督检验站)国内六家单位发起,在2015年9月7日召开23家理事单位首次会议,宣告正式成立。聘任北矿检测技术有限公司总经理李华昌为首届理事长、王海舟院士为专家委员会主任。

联盟的组织原则: 合作、共商、共享、共赢。

联盟的宗旨: 为矿冶行业提供优质高效检测服务,统一规范矿冶检测技术,强化检测质量,扩大国内矿冶检测机构在国际上的话语权,并最终实现统一的联盟品牌,共同走向国际检测市场。

联盟的目标: 通过构建跨区域的矿冶检测公共技术服务平台,推动其在我国传统产业转型升级中的技术保障支撑作用,促进矿冶产业的科学发展。

中国矿冶检测机构联盟成员名单

理事长单位：国家重有色金属质量监督检验中心/北矿检测技术有限公司

副理事长单位（7家）：钢研纳克检测技术有限公司、国家金银及制品质量监督检验中心（长春）、国家矿物及再生金属材料质量监督检验中心、国家轻金属质量监督检验中心、北京市冶金产品质量监督检验站、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心。

理事单位（15家）：有色金属桂林矿产地质测试中心、大冶有色设计研究院有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、山东祥光集团有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、云南铜业股份有限公司检验分析中心、中条山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司质量检测中心、山东国大黄金股份有限公司、云南锡业集团有限责任公司研究设计院、金川集团股份有限公司检测中心、铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心、中国物流与采购联合会稀贵金属质量监督检验测试中心。